

ACTA DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LP/E/SSA/020/2019** CONVOCADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE "BOLSA SEGURA", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO. -----

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019, ESTANDO PRESENTE EL **C.P MANUEL PELEATO DÁVALOS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**, Y REPRESENTANTE DEL **DR. SERGIO GÓNZALEZ ROMERO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO**, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACION, Y REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN EL AULA ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 225 NORTE, C.P. 34000, ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO **LP/E/SSA/020/2019**, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA "LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE "BOLSA SEGURA", DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS Y POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.-----

**ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMERO.-** SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **C.P MANUEL PELEATO DÁVALOS**, A TODOS LOS PRESENTES.-----

**SEGUNDO.-** SE CUENTA CON PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES:


- 1.- SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRÚRGICO S.A DE C.V
- 2.- CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL S.A DE C.V
- 3.- DISTRIBUIDORA LHAG S.A DE C.V
- 4.- LABORATORIOS LICON S.A
- 5.- COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE C.V

**TERCERO.-** SE SEÑALAN LAS PRECISIONES A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO POR PARTE DE LA CONVOCANTE, LAS CUALES SE INSERTAN EN EL ANEXO 1, ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA.

**CUARTO.-** SE SEÑALA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS, SE RECIBIERÓN EN TIEMPO Y FORMA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCANTE POR PARTE DE LAS EMPRESAS SIMLAE, CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL S.C DE C.V., SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRÚRGICO S.A DE C.V. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN S.A DE C.V, TERUMO BCT MEXICO S.A DE C.V Y DISTRIBUIDORA LHAG S.A DE C.V POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA A DICHAS ACLARACIONES, ASÍ MISMO SE MANIFIESTA QUE LAS ACLARACIONES SE INSERTAN EN EL ANEXO 2, EL CUAL SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.-----

**QUINTO.-** SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE LICITANTES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **20 DE JUNIO DEL AÑO 2019**, A PARTIR DE LAS **11:00 A LAS 11:50 HRS**, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000 DURANGO, DGO., ASÍ MISMO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **20 DE JUNIO DEL AÑO 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS**, EN LA SALA DE JUNTAS ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CUAUHTÉMOC NÚMERO 225 NORTE, C.P. 34000, DURANGO DGO.-----

**SEXTO.-** AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA SE ENTREGARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN ELLA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE HAYAN ADQUIRIDO BASES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TÉRMINO DEL EVENTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN SOLICITAR COPIA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES VÍA TELEFÓNICA EN UN HORARIO DE LAS

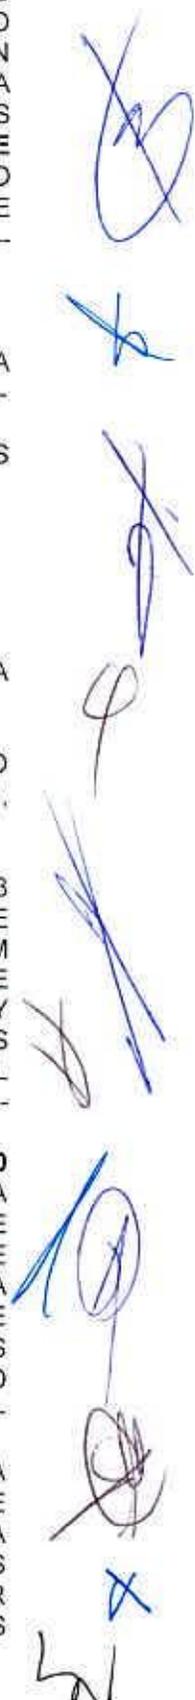

9:00 A LAS 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 / 1 37 74 82 Ó A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO [licitaciones.ssd@durango.gob.mx](mailto:licitaciones.ssd@durango.gob.mx), ASI COMO EN LA PAGINA DE SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES [comprasestatal.durango.gob.mx](http://comprasestatal.durango.gob.mx) PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA SU OBSERVANCIA OBLIGATORIA.-----

**CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES, NI POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DECLARA **C.P. MANUEL PELEATO DÁVALOS**, TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 13:51 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, CONSTE.-----

**POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO**

**C.P. MANUEL PELEATO DÁVALOS**  
REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZALEZ ROMERO  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

**DR. HERIBERTO ANDIOLA GALVÁN**  
DIRECTOR DEL CETS.

**C.P. JULIO JESUS MAGALLANES BARRERA**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN DE LOS SSD



**QFB I. MARTIN HINOJOSA DELGADO**  
COORDINADOR DE LA RED DE SANGRE


**LIC. DANIELA SOTO BURCIAGA**  
ADMINISTRADORA DE COPRISED

**DR. OSCAR ROLANDO ÁVILA GÁLVAN**  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y  
CONTRATOS

**ING. HERNÁN HUBERTO HERNÁNDEZ**  
CARRILLO  
ADMINISTRADOR DEL CETS


**POR LOS LICITANTES**

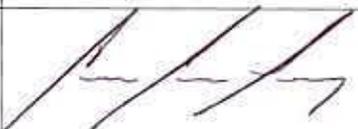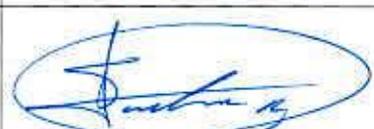NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE REPRESENTANTE DEL	FIRMA
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRÚRGICOS S.A DE C.V	GERARDO CRUZ LICERIO	
CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL S.A DE C.V	SERGIO TADEO ARJONA RIVERA	
DISTRIBUIDORA LHAG S.A DE C.V	RICARDO LEVITH NUÑEZ NEPOMUCENO	







X

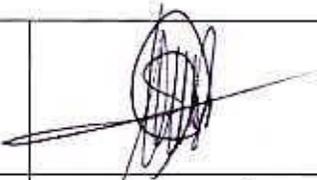
LABORATORIOS LICON S.A	ROSALBA CORONA ARREGOITE	
COMERCIALIZADORA DE RACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE C.V	OCTAVIO CASTRO GALLARDO	










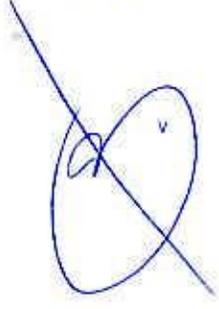



ACLARACIÓN A LAS BASES

ACLARACIÓN 1.

NUMERAL 7.3 Y 12 DE LAS BASES

DICE:

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN
GRUPO ÚNICO (Partida 1)	PARTIDA 1.1	BOLSA SEGURA
	PARTIDA 1.2	AFERESIS SEGURA
	PARTIDA 1.3	AFERESIS TERAPEUTICA
	PARTIDA 1.4	BIOMETRIA HEMATICA RECHAZADOS
	PARTIDA 1.5	PRUEBAS MANUALES.

DEBE DECIR:

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN
GRUPO ÚNICO (Partida 1)	1.1	BOLSA SEGURA
	1.2	AFERESIS SEGURA
	1.3	AFERESIS TERAPEUTICA
	1.4	BIOMETRIA HEMATICA RECHAZADOS
	1.5	PRUEBAS MANUALES

Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be initials or names, and some circular or scribbled marks. The marks are scattered across the right margin, with some overlapping the right edge of the tables.

### ACLARACIÓN 2.

#### NUMERAL 8. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

#### 2. TRES EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA HEMATOLOGÍA (MEDIANO RENDIMIENTO)

DICE	DEBE DECIR
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 PARA EL C.E.T.S.</li><li>• 1 PARA EL HOSPITAL GENERAL DE GÓMEZ PALACIO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 PARA EL C.E.T.S. (UNO DE 5 PARTES Y UNO DE 3 PARTES)</li><li>• 1 PARA EL HOSPITAL GENERAL DE GÓMEZ PALACIO (DE 3 PARTES)</li></ul>

### ACLARACIÓN 3.

#### NUMERAL 8. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

#### 2. TRES EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA HEMATOLOGÍA (MEDIANO RENDIMIENTO)

DICE	DEBE DECIR
<ul style="list-style-type: none"><li>• CBC CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CBC CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PARA EL C.E.T.S. Y 3 PARTES PARA EL C.E.T.S Y HOSPITAL GENERAL DE GÓMEZ PALACIO</li></ul>

Handwritten blue ink annotations and signatures on the right side of the page. There are several scribbles, a large arrow pointing downwards, and what appears to be a signature or initials at the bottom right.



PRESENTE LICITACIÓN Y QUE NOS COMPROMETEMOS A SER RESPONSABLES SOLIDARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS SIGUIENTES BIENES OFERTADOS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

LO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17. INCISO JJ) DE LAS PRESENTES BASES.

LUGAR Y FECHA


ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**ACLARACIÓN 5**

ANEXO 1. REPORTE DE PARTIDAS PARTIDA 1, SUB PARTIDAS 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.4

DICE	DEBE DECIR
HEMATOLOGÍA: PRUEBA DE BIOMETRÍA HEMÁTICA DE 5 PARTES	HEMATOLOGÍA: PRUEBA DE BIOMETRÍA HEMÁTICA DE 5 Y 3 PARTES PARA EL C.E.T.S.; ASÍ COMO DE 3 PARTES PARA EL HOSPITAL DE GOMEZ PALACIO.

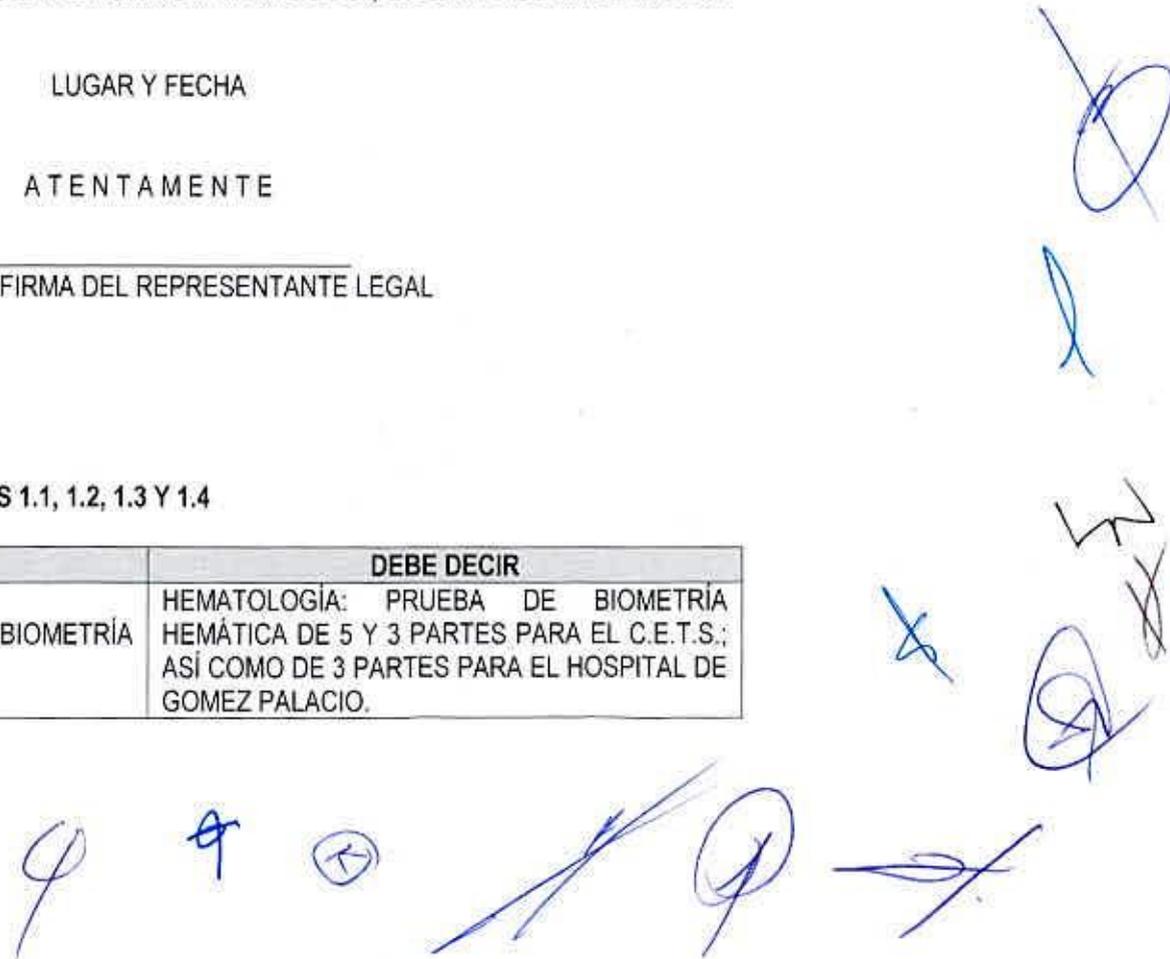

## ACLARACIÓN 6

### NUMERAL 8. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE LA POTENCIA Y/O FRECUENCIA ELÉCTRICA, INCLUIR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTOS PUNTOS Y ADJUNTAR A LA FICHA TÉCNICA.

## ACLARACIÓN 7

SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA BANCO DE SANGRE EN LA PRESENTE LICITACIÓN:

ANEXO 8-A								
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CETS	GOMEZ PALACIO	MATERNO INFANTIL	HOSPITAL 450	SANTIAGO PAPASQUIARIO	CUENCAME	SANTA MARIA DEL ORO
4	Equipos automatizados para la separación de componentes sanguíneos de alto rendimiento	4	0	0	0	0	0	0
1	Sistema automatizado de aféresis portátil para procedimientos de aféresis terapéutica y terapia	1	0	0	0	0	0	0
2	Sistema automático de aféresis portátil, para la colección de plaquetas, plasma, concentrado eritrocitario y doble concentrado eritrocitario leucodepletados	2	0	0	0	0	0	0
1	Equipos automatizados en comodato para serología alto rendimiento	1	0	0	0	0	0	0
1	Equipos automatizados en comodato para serología mediano rendimiento	0	1	0	0	0	0	0
1	Equipo automatizado en comodato para hematología mediano rendimiento (5 partes)	1	0	0	0	0	0	0

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

2	Equipo automatizado en comodato para hematoloia mediano rendimiento (3 partes)	1	1	0	0	0	0	0
3	Equipo automatizado para Inmunoematologia	1	1	1		0		
7	Equipo semi automatizado para Inmunoematologia	1	1	1	1	1	1	1
1	Equipo semi automatizado para Coagulaci3n	1	0	0	0	0	0	0

ANEXO 8-B								
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CETS	GOMEZ PALACIO	MATERNO INFANTIL	HOSPITAL 450	SANTIAGO PAPASQUIARIO	CUENCAME	SANTA MARIA DEL ORO
4	Selladores dieléctricos Portátiles	4	0	0	0	0	0	0
5	Selladores dieléctricos fijos	5	0	0	0	0	0	0
10	Recolectores (Agitadores de Sangre)	10	0	0	0	0	0	0
4	Equipos de Conexi3n Estéril	4	0	0	0	0	0	0
3	Extractores de plasma	3	0	0	0	0	0	0
10	Sillones para banco de sangre	10	0	0	0	0	0	0
4	Centrifugas refrigeradas	2	1	0	0	1	0	0
4	Balanzas de precisi3n para laboratorio	2	1	0	0	1	0	0
5	Centrifugas de Mesa	2	1	1	1	0	0	0
2	Equipo no invasivo para el análisis de hemoglobina de sangre	2	0	0	0	0	0	0

**ANEXO 2.  
BANCO DE SANGRE:**

SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SSA/020/2019  
PARA LA ADQUISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE (BOLSA SEGURA)

**PROVEDOR SIMLAE**

PREGUNTAS:

CON RESPECTO A INMUNOHEMATOLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CON TARJETAS DE 8 MICROPOZOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER DE CARACTER ONBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR EQUIPOS CON OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS SEIS MESES QUE INDICAN EN BASES, ESTO DEBIDO A QUE, SI USTEDES SOLICITAN EQUIPO NUEVO ENCARECERIA LA PRUEBA, SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.**

3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA INSTALACIÓN DE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS EN UN PERIODO AL MENOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES AL FALLO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.**

4. CON RESPECTO AL EQUIPO DE HEMATOLOGÍA, EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO SE SOLICITA UN EQUIPO CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES, PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS MENCIONA PRUEBA DE BIOMETRÍA HEMÁTICA DE 5 PARTES, FAVOR DE ACLARAR CUÁL ES EL CORRECTO.

**RESPUESTA: FAVOR DE REVISAR LAS ACLARACIONES DE LA PRESENTE JUNTA.**

5. CON RESPECTO A LAS PRUEBAS MANUALES (REACTIVOS PARA PRUEBA EN TUBO) FAVOR DE ACLARAR SI LA CANTIDAD EN LISTADA CORRESPONDE AL NÚMERO DE PRUEBAS O AL NÚMERO DE FRASCOS QUE SE DEBEN DE ENTREGAR.

**RESPUESTA: NOS REFERIMOS AL NUMERO DE FRASCOS QUE SE REQUIEREN EN CATIDADES MINIMAS Y MAXIMAS.**

6. CON RESPECTO A LAS 4 BALANZAS DE PRECISIÓN SOLICITADAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS QUE REQUIEREN.

**RESPUESTA: DE 100 GRs A 5000 GRS**

7. CON RESPECTO AL EQUIPO PARA SEROLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO CON TECNOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER DE CARACTER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

8. CON RESPECTO AL EQUIPO DE SEROLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO QUE SOLICITAN COMO RESPALDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON IGUAL TECNOLOGÍA, AUNQUE LOS REACTIVOS NO SEAN COMPATIBLES EN LOS DOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PORPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.**

9. CON RESPECTO AL EQUIPO DE SEROLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA DE PISO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.**

10. CON RESPECTO A EQUIPO PARA PLAQUETAFERESIS QUE DESCRIBE LO SIGUIENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SET DE PLAQUETAFERESIS FUNCIONALMENTE CERRADO, QUE INCLUYE FILTRO BACTERIOLOGICO EN LA LÍNEA DEL ANTICOAGULANTE PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS RECOLECTADOS, CON SISTEMA UNIPUNCIÓN QUE PERMITE REALIZAR EL ACCESO Y RETORNO DE LA SANGRE POR UNA SOLA VÍA CON FLUJO CONTINUO QUE DISMINUYE LA DURACIÓN DE LA DONACIÓN, CON UN VOLUMEN EXTRACORPOREO NO MAYOR A 196 ML PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL DONADOR, QUE INCLUYA CAMARA BICONICA PARA LEUCORREDUCCIÓN DE LAS PLAQUETAS RECOLECTADAS, CON CASSETTE PARA MONITOREAR LA PRESIÓN DE ACCESO Y RETORNO Y EL FLUJO DE LOS FLUIDOS, CINTURON PARA CENTRIFUGAR Y SEPARAR LA SANGRE ANTICOAGULADA, QUE INCLUYA 2 BOLSAS PARA LA OBTENCION DE CONCETRADOS PLAQUETARIOS Y AGUJA DE 17 G. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO, PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

**CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.,**

#### **PREGUNTAS LEGAL – ADMINISTRATIVAS**

PREGUNTA 1

8. DESCRIPCION DE LOS BIENES

SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, EL TIEMPO PARA ENTREGAR E INSTALAR LOS EQUIPOS SEA DE 15 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.**

PREGUNTA 2.

17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, EL TIEMPO PARA ENTREGAR E INSTALAR LOS EQUIPOS SEA DE 15 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLICA PARA MI REPRESENTADA, SE PERMITA PRESENTAR EL FORMATO (EN CASO DE EXISTIR) CON LA LAYENDA NO APLICA EN MARCA DE AGUA.

SE ACEPTA:

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

PREGUNTA 3

17. - REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO INCISO JJ) PÁG. 25

DEBEMOS ENTENDER QUE AL NO EXISTIR ANEXO 14 EN LAS PRESENTES BASES, ESTE NO SE DEBERA PRESENTAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR

EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE DICHO ANEXO.

RESPUESTA: FAVOR DE REVISAR LAS ACLARACIONES DE LA PRESENTE ACTA.

PREGUNTA 4

ANEXO 13 SUB-PUNTO 3 ENTREGA DE EQUIPOS

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE 4-5 AÑOS DE FABRICACIÓN, DE TECNOLOGÍA DE PUNTA, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

PREGUNTAS TÉCNICAS

PREGUNTA 1

15.1 FOLDER ASPECTOS TECNICOS PÁG. 24

DEBEMOS ENTENDER QUE PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA SOLO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

POR LO TANTO, NO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ASI COMO LOS EQUIPOS EXTRAS QUE SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 1 Y 12 (NUMERAL 8).

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR

RESPUESTA: FAVOR DE REVISAR LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 2

ANEXO 2 DESCRIPCION TECNICA BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUADRUPE PÁG. 33

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR UNA BOLSA CON AGUJA DE 16 G TRIBISELADA Y SILICONADA, LA CUAL PERMITE UNA PUNCION INDOLORA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 3

ANEXO 2 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION PANTALLA TACTIL A COLOR DE 7 PULGADAS

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO EL CUAL CUENTA CON UN MONITOR TACTIL DE 24 PULGADAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 4

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES CENTRIFUGA DE MESA ABIERTA PÁG. 15

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD PARA TUBOS DE HASTA 12X75MM Y CON RANGO DE 500 HASTA 5000 RPM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

PREGUNTA 5

ANEXO 2 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMO DATO PARA SEROLOGIA

DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL PRIMER PUNTO EN EL CUAL HACE REFERENCIA EN LA DESCRIPCION DEL MENU DE PRUEBAS A REALIZAR SOLO DEBERA OFERTAR HIV, HBSAG, HCV, SIFILIS Y CHAGAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

PREGUNTA 6

ANEXO 2 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMO DATO PARA SEROLOGIA DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL PUNTO 13. CARGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PERMITE 5 HORAS DE OPERACION DE MANOS LIBRES HACE REFERENCIA A LA CARGA CONTINUA Y/O A LA PROGRAMACION DE PACIENTES EN FORMA CONTINUA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: A LA PROGRAMACIÓN DE CARGA CONTINUA.**

PREGUNTA 7

DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL PUNTO 13. CARGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PERMITE 5 HORAS DE OPERACION DE MANOS LIBRES HACE REFERENCIA A LA CARGA CONTINUA Y/O A LA PROGRAMACION DE PACIENTES EN FORMA CONTINUA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: SE REPITE PREGUNTA**

PREGUNTA 8

ANEXO 2 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMO DATO PARA SEROLOGIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUBRIR EL INCISO G NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UNA MEMORIA INTERNA DE 10,000 RESULTADOS CON LA ALTERNATIVA DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DEL SOFTWARE Y HARDWARE QUE SE INSTALARA, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.**

PREGUNTA 9

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO PARA SEROLOGIA. 1. DOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA SEROLOGÍA.EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA ROTOR REFRIGERADO (4+/-8°C).PÁG. 12.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN ROTOR REFRIGERADO (20°C +/-3°C) COMO LO MENCIONA EL ANEXO 2 DESCRIPCION TECNICA. EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA SEROLOGIA, PUNTO 5, PÁGINA 34. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.**

PREGUNTA 10

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO PARA SEROLOGIA. 1. DOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA SEROLOGÍA.EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA CARGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PERMITE 5 HORAS DE OPERACIÓN DE MANOS LIBRES. PÁG. 12.

DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA CARGA CONTINUA Y/O A LA PROGRAMACION DE PACIENTES EN FORMA CONTINUA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

PREGUNTA 11

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO PARA SEROLOGIA. 1. DOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA SEROLOGÍA.EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA. CON CAPACIDAD DE 25 REACTIVOS REFRIGERADOS

PÁG. 12.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD PARA 15 REACTIVOS A 20°C +/- 3°C. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.**

PREGUNTA 12

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO PARA SEROLOGÍA. 1. DOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA SEROLOGÍA. EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA.  
1 EQUIPO DE RESPALDO...

PÁG. 13.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE EL EQUIPO DE RESPALDO SOLICITADO PARA EL EQUIPO PARA MEDIANO RENDIMIENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO EVCCARECER LA PROPUESTA.

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

PREGUNTA 13

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION.

PÁG. 15.

DEBEMOS ENTENDER QUE NO SE DEBE OFERTAR UN EQUIPO PARA COAGULACION YA QUE NO VIENE NINGUNA PARTIDA NI SUBPARTIDAS CON CANTIADES MINIMAS Y MAXIMAS PARA LAS PRUEBAS DE COAGULACION EN EL ANEXO 1. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR. EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, FAVOR DE PROPORCIONAR CANTIADES MINIMAS Y MAXIMAS.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRESIACIÓN.**

PREGUNTA 14

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE 60 PRUEBAS POR HORA ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARACTER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

PREGUNTA 15

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION.

SISTEMA DE INCUACION PARAMUESTRAS Y REACTIVOS A 37°C.

PÁG. 15.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SISTEMA DE INCUBACION PARA MUESTRAS DE 37°C Y PARA REACTIVOS DE 15°C +/- 2°C. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

PREGUNTA 16

BIENES. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION. PERMITA GUARDAR LAS CALIBRACIONES, CONTROLES DE CALIDAD Y LOS ARCHIVOS DE PACINETES.

PÁG. 15.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 3000 RESULTADOS Y CON UN PUERTO SERIE PARA CONECTAR LA UNIDAD A UN ORDENADOR CENTRAL. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARACTER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

**PREGUNTA 17**

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION.

PANTALLA TACTIL A COLOR DE 7 PULGADAS.

PÁG. 15.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA TACTIL DE 3.2 X 3.4 PULGADAS A COLOR. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARACTER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

PREGUNTA 18 DESCRIPCION DE LOS BIENES, DOS EQUIPOS NO INVASIVOS, PARA EL ANALISIS DE HEMOGLOBINA DE SANGRE PAG 15.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS.

**RESPUESTA: MISMA CANTIDAS QUE LA BIOMETRIA HEMATICA.**

**PREGUNTA 18**

ANEXO 1 REPORTE DE PARTIDAS PÁG. 30 Y ANEXO 2 DESCRIPCION TECNICA PÁG. 34

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PRUEBA DE HTLV 1 DEL PANEL DE SEROLOGIA DE MARCADORES PARA BANCO DE SANGRE SEA OPTATIVA. YA QUE DICHA PRUEBA NO CORRESPONDE A LAS SOLICITADAS OBLIGATORIAMENTE POR LA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.**

**PREGUNTA 20**

ANEXO 1 REPORTE DE PARTIDAS PÁG. 30 Y ANEXO 2 DESCRIPCION TECNICA PÁG. 34

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PRUEBA DE HTLV 1 DEL PANEL DE SEROLOGIA DE MARCADORES PARA BANCO DE SANGRE NOS PERMITA PROCESARLA EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

**PREGUNTA 21**

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES PÁG. 9 A LA 22 Y ANEXO 12 DISTRIBUCION DE EQUIPOS PÁG. 49 EN CASO DE PRESENTAR ESTE ANEXO, EL CUAL NO ESTA SOLICITA EN EL NUMERAL 15.1 FOLDER ASPECTOS TECNICOS, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ANEXO (12) SE REFIERE A LA DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO; EL CUAL SE DEBERA PRESENTAR CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS SOLICITADOS.

¿ES CORRECTA NUESTRA PRESENTACION? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION ADEMAS DE REVISAR LAS ACLARACIONES DE LA PRESENTE JUNTA.**

**PREGUNTA 22**

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES PÁG 12

DEBEMOS ENTENDER QUE AL NO HABER UNA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL ANEXO 2 PARA UN EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO DE SEROLOGIA NO SE DEBE OFERTAR DICHO EQUIPO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA: SE DEBE OFERTAR CON ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EQUIPOS DE SEROGIA DE MEDIANO RENDIMIENTO**

**PREGUNTA 23**

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES PÁG14

DEBEMOS ENTENDER QUE AL NO HABER UNA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL ANEXO 2 PARA UN EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA NO SE DEBE OFERTAR DICHO EQUIPO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION.**

**PREGUNTA 24**

ANEXO 2 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION EQUIPO PARA 120 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE SOLICITAR PRUEBAS ESPECIALES Y FACTORES DE LA COAGULACION, NOS PERMITA PROCESARLAS EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

**PREGUNTA 25**

ANEXO 1 HEMATOLOGIA PRUEBA DE BIOMETRIA HEMATICA

DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO SOLICITADO PARA PROCESAR LA PRUEBA DE BIOMETRIA HEMATICA DEBE SER UN EQUIPO CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES COMO LO INDICA EN LA SECCION DE EQUIPO REQUERIDO PARA LA RECOLECCION DE SANGRE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA: FAVOR DE REVISAR LAS ACLARACIONES DE ESTA ACTA.**

**PREGUNTA 26**

ANEXO 2 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMO DATO PARA SEROLOGIA INCISO F) PÁGINA. 34

DEBEMOS ENTENDER QUE EL CONTROL HISTORICO AUTOMATICO Y REGISTRO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS SON PROPIAS DE CADA MARCA Y SE DEBEN REFRENCIAR DE ACUERDO CON LA SERIE DE EVENTOS QUE SUCEDE EN EL EQUIPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 27**

8.-DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO PARA SEROLOGIA. 1. DOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA SEROLOGÍA. EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA.

SOFTWARE, F) CONTROL HISTORICO AUTOMATICO Y REGISTRO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS. PÁG. 13.

DEBEMOS ENTENDER QUE EL CONTROL HISTORICO AUTOMATICO Y REGISTRO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS SON PROPIAS DE CADA MARCA Y SE DEBEN REFRENCIAR DE ACUERDO A LA SERIE DE EVENTOS QUE SUCEDE EN EL EQUIPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

**PREGUNTAS ECONOMICAS**

**PREGUNTA 1**

ANEXO 1 (PÁG. 30)

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA DEMANDA MAXIMA ES MENSUAL O POR EL TOTAL DEL PERIODO.

**RESPUESTA: ES DEMANDA POR TOTAL DEL PERIODO. DE 6 MESES.**

**PREGUNTA 2**

ANEXO 3 (PAG38)

SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE SI LOS CONSUMIBLES, CALIBRADORES E INSUMOS TIENEN QUE SER CALCULADOS EN BASE A LAS DEMANDAS MÁXIMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**PREGUNTA 3**

ANEXO 3 (PÁG. 38)

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL ANEXO 3 EN LA CELDA QUE DICE GRUPO SE REFIERE A PARTIDA, LA CELDA DE SUBGRUPO SE REFIERE A SUBPARTIDA Y LA CELDA PRESENTACIÓN SE REFIERE A LA DESCRIPCIÓN, TAL COMO SE MUESTRA EN EL "ANEXO 1 REPORTE DE PARTIDAS", FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: FAVOR DE REVISAR LAS ACLARACIONES DE ESTA ACTA.

**PREGUNTA 4**

ANEXO 3 PAG 38

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PLASMAR EN EL ANEXO 3 PROPUESTA ECONÓMICA, LA LEYENDA "LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO", YA QUE EL HACER ANOTACIONES ADICIONALES ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA Y ES DE CARACTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

**SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO SA DE CV.**

**1º PREGUNTA**

PAG 33 ANEXO 2. "BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE CON ANTICOAGULANTE CPD-OPTISOL"

- Solicito a la convocante nos permita ofertar nuestra bolsa para fraccionar sangre Cuádruple Top and Bottom: contiene una bolsa primaria de  $450 \pm 10\%$  con 63 ml de solución anticoagulante CPD, conectada a un tubo colector integral y a un sistema secundario formado por 3 bolsas con capacidad de 600 ml cada una, una de ellas para almacenar Plasma y otra para almacenar plaquetas por 5 días, por la parte inferior está unida una bolsa que contiene 100 ml de solución aditiva SAG-MANITOL que proporciona 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario; con aguja retráctil calibre 16 G trifacial, con tapón que abre fácilmente y protector de aguja irreversible. Sitio con toma de muestra Composampling, con pinza de seguridad irreversible. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SE APRECIACIÓN.

**2º PREGUNTA**

PAG 33 ANEXO 2. "EQUIPO PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA CON UN VOLUMEN EXTRACORPÓREO DE 196 ML"

- Solicito a la convocante nos permita ofertar con nuestro sistema de aféresis de flujo continuo para la colección de plaquetas, plasma y concentrado eritrocitario en unipunción. Sistema cerrado en la obtención de plaquetas, soluciones preconectadas. Cuenta con brazaletes y manguito que permiten un flujo constante y adecuado para tener menos oclusiones, control automatizado de anticoagulante, detector de interfase integrado en el compartimento de la centrifuga para una separación completa automatizada, con infusión de solución salina integrada sin abrir sistema para mantener al donador isovolémico, permite introducir el volumen medio plaquetario para eficientar la colección de plaquetas y determinar el líquido de almacenamiento, control de infusión de citrato al donador. Volúmenes extracorpóreos bajos de un rango de 150 a 250 ml. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.

**3º PREGUNTA**

PAG 34, ANEXO 2. "BOLSA TRANSFER DE 300 ML"

- Solicito a la convocante nos permita ofertar nuestra bolsa transfer de 400 ml con acoplador, dando una mayor capacidad para los productos. ¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.**

**4º PREGUNTA**

PAG 34 ANEXO 2. "NAVAJA PARA CONEXIÓN ESTÉRIL"

- Solicito a la convocante nos permita ofertar nuestro equipo de conexión estéril de alta frecuencia sin navajas lo cual disminuye riesgos y desechos. ¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.**

**5º PREGUNTA**

PAG 10, PUNTO 7. "UN SISTEMA DE AFÉRESIS PORTÁTIL PARA PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA"

- Solicito a la convocante nos permita ofertar máquina que se pueda trasladar a los servicios, ruedas con seguro, postes para soluciones retráctil y diseño que permiten el desplazamiento de una forma sencilla. Sistema de aféresis de flujo continuo, colección de recambio plasmático y células mononucleares en doble punción, control automatizado de anticoagulante, detector de interfase integrado en el compartimento de la centrifuga para una separación completa automatizada, con infusión de solución salina integrada sin abrir sistema para mantener al paciente/donador isovolémico, volúmenes extracorpóreos en recambio plasmáticos de 160 ml y células mononucleares de 163 ml, bajo secuestro de plaquetas para recambios plasmáticos y células mononucleares.  
¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.**

**6º PREGUNTA**

PAG 11, PUNTO 8. "DOS SISTEMAS DE AFÉRESIS PORTÁTIL PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA Y CONCENTRADO ERITROCITARIO Y DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADOS"

- Solicito a la convocante nos permita ofertar nuestro sistema de flujo continuo diseñado para únicamente para la colección de doble concentrado eritrocitario en sistema unipunción, equipo totalmente portátil con batería de reserva integrada, cuenta con 5 balanzas que permiten calcular volumen de los líquidos (ACD, SALINA, PLASMA, HEMATÍES Y DE PROCESO), filtración y adición de solución aditiva para la conservación de los glóbulos rojos por 42 días de manera automática, con infusión de solución salina integrada sin abrir el sistema para mantener al donador isovolémico, soluciones preconectadas de fábrica, mobile car único opcional para facilitar el uso del equipo en las campañas de donación externa, productos leucodepletados < 1.0 x 10<sup>6</sup>, volúmenes extracorpóreos de 110 ml. Peso de 24 kg. ¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.**

**7º PREGUNTA**

PAG 11, PUNTO 10, J) y K). "ESPECIFICACIONES"

- Solicito a la convocante nos aclare las especificaciones que requiere para los siguientes equipos:
  - 10) 4 Centrifugas Refrigeradas ¿Capacidad o número de vasos?
  - J) 7 Agitadores de Plaquetas ¿Con o sin incubadora, capacidad?
  - K) 3 Congeladores verticales ¿Capacidad?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.**



**PREGUNTA 1**

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: PUNTO 17, INCISO (BB).

EN RELACION A ESTE PUNTO, Y HACIENDO REFERENCIA A LA LAASSP, CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULO 28, INCISO II.

CONSIDERANDO QUE EN ESTE EVENTO SE LICITA UN SERVICIO (SERVICIO INTEGRAL DE ANCO DE SANGRE) ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARA OFERTAR EQUIPOS E INSUMO FABRICADOS EN MEXICO Y/O EN OTROS PAISES, EN TANTO EL OFERTANTE SEA DE NACIONALIDAD MEXICANA Y/O DE ALGUNO DE LOS PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE FIRMADO ALGUN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE?

¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 2**

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: EQUIPO REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE SANGRE, PUNTO 4.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR RECOLECTORES DE SANGRE QUE ADEMÁS DE CUMPLIR CON TODAS LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS CUENTE CON BANDEJA DE PLASTICO UNIDA MAGNETICAMENTE AL SISTEMA DE OSCILATORIO Y QUE GARANTIZA LA ADECUADA COLOCACIÓN DE LAS BOLSAS RECOLECTORAS Y EL MEZCLADO DE LA SANGRE CON EL ANTICOAGULANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

**PREGUNTA 3**

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DESCRIPCIÓN DE EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMÁTICO ADULTO

REFERENTE A LO DESCRITO EN EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA "EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMÁTICO ADULTO", QUE DESCRIBE LO SIGUIENTE:

*"ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: UNA LINEA OPCIONAL PARA VENA ABIERTA. 1 LINEA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE CON ADAPTADOR PARA CATETER O AGUJA. CARTUCHO PARA BOMBA DE ANTICOAGULANTE LINEA DE ANTICOAGULANTE CON FILTRO Y PUNZON, LINEA PARA CONECTAR AL MONITOR DE PRESION DEL DONADOR LINEA PARA CONECTAR AL MONITOR DE PRESION DEL SISTEMA (SMP) CARTUCHO DE LAS BOMBAS DE SANGRE Y PLASMA, FILTRO DE SANGRE 2 LINEAS CONECTORAS PARA LA SOLUCION DE REEMPLAZO 1 LINEA CONECTORA PARA LA BOLSA DE DESECHO 1 BOLSA DE DESECHO DE PLASMA 1 BOLSA DE REEMPLAZO PARA FLUIDO 1 PUERTO DE INYECCION EN LA LINEA DE EXTRACCION, 1 CAMARA DE GOTEO DE ANTICOAGULANTE EL EQUIPO SERA CERRADO DE PLÁSTICO COMPATIBLE CON EL SISTEMA INSTRUMENTO BIOMEDICO DE AFERESIS QUE SE PROPORCIONE EN COMODATO PARA SU USO"*

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE PARA ESTA SUB PARTIDA, EL LICITANTE DEBERA OFERTAR UN SET DE LINEAS PARA RECAMBIO PLASMÁTICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

SET DE LINEAS DESECHABLE CON CAPACIDAD DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO UTILIZANDO UN VOLUMEN EXTRACORPOREO MENOR A 196 ML PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, FUNCIONALMENTE CERRADO, LINEAS DE ACCESO RETORNO PARA FUNCIONAR CON DOBLE PUNCIÓN O CAPACIDAD CAMBIAR A UNIPUNCIÓN, CAPACIDAD DE TRABAJAR CON CATETER O CAMBIAR A PUNCIÓN VENOSA, CON FILTRO BACTERIOLOGICO EN LA LINEA DE ANTICOAGULANTE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN EXTERNA, DOS LINEAS PARA CONEXIÓN DE FLUIDO DE REEMPLAZO, BOLSA PARA DESECHO CON CAPACIDAD DE 6 LITROS, LINEA PARA CONEXIÓN DE LA SOLUCIÓN FISIOLÓGICA, CON CASSETTE QUE PERMITE MONITOREAR LAS PRESIONES DE ACCESO Y RETORNO DE FLUIDOS, QUE INCLUYA UN CINTURON PARA CENTRIFUGAR Y SEPARAR LA SANGRE TOTAL ANTICOAGULADA, DE FLUJO CONTINUO Y QUE SEA CONTROLADA POR EL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE LA INTERFAZ (AIM)

¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 4**

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DESCRIPCIÓN DE EQUIPO PARA PLAQUETAFERESIS.

REFERENTE A LO DESCRITO EN EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA "EQUIPO PARA PLAQUETAFERESIS" QUE DESCRIBE LO SIGUIENTE:

"PARA OBTENER PLAQUETAS CON VIABILIDAD DE 5 DÍAS. CON FILTRO LEUCORREDUCTOR INTEGRADO, ADULTO, ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: UNA LÍNEA DE EXTRACCIÓN Y REINFUSIÓN CON AGUJA DE CAL 17 G. CARTUCHO PARA BOMBA DE ANTICOAGULANTE. LINEA DE ANTICOAGULANTE CON FILTRO. FILTRO BARRERA DE BACTERIAS. FILTRO DE SANGRE FILTRO LEUCORREDUCTOR CONTINUO PARA CONCENTRADOS PLAQUETARIOS DE  $3,4 \times 10^6$  A LA  $11 \times 10^6$  O MÁS. LÍNEA PARA CONECTAR AL MONITOR DE PRESIÓN DEL DONADOR (DPM). CARTUCHO DE LAS BOMBAS DE SANGRE Y PLASMA. LÍNEA DE SOLUCIÓN SALINA PARA REEMPLAZO. LÍNEA PARA CONECTAR A MONITOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA (SPM). UNA BOLSA DE PLASMA. UNA BOLSA DE AIRE. DOS BOLSAS PARA EL COLECTOR DE PLAQUETAS. UNA BOLSA PARA MUESTREO DE PLAQUETAS. UNA BOLSA DE MUESTREO DE SANGRE TOTAL. UN PUERTO DE INYECCIÓN EN LA LÍNEA DE EXTRACCIÓN. UNA CAMARA DE GOTEO ANTICOAGULANTE. EL EQUIPO SERA CERRADO DE PLASTICO COMPATIBLE CON EL SISTEMA INSTRUMENTO BIOMEDICO DE AFERESIS QUE PROPORCIONE EN COMODATO PARA SU USO"

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE PARA ESTA SUB PARTIDA, EL LICITANTE DEBERA OFERTAR UN SET DE LINEAS PARA RECAMBIO PLASMATICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

SET DE PLAQUETAFERESIS FUNCIONALMENTE CERRADO, QUE INCLUYE FILTRO BACTERIOLOGICO EN LA LÍNEA DEL ANTICOAGULANTE PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS RECOLECTADOS, CON SISTEMA UNIPUNCIÓN QUE PERMITE REALIZAR EL ACCESO Y RETORNO DE LA SANGRE POR UNA SOLA VÍA CON FLUJO CONTINUO QUE DISMINUYE LA DURACIÓN DE LA DONACIÓN, CON UN VOLUMEN EXTRACORPOREO NO MAYOR A 196 ML PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL DONADOR, QUE INCLUYA CAMARA BICONICA PARA LEUCORREDUCCIÓN DE LAS PLAQUETAS RECOLECTADAS, CON CASSETTE PARA MONITOREAR LA PRESIÓN DE ACCESO Y RETORNO Y EL FLUJO DE LOS FLUIDOS, CINTURON PARA CENTRIFUGAR Y SEPARAR LA SANGRE ANTICOAGULADA, QUE INCLUYA 2 BOLSAS PARA LA OBTENCION DE CONCETRADOS PLAQUETARIOS Y AGUJA DE 17 G ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

#### PREGUNTA 5

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:  
ANEXO 13 PUNTO 3.

"ENTREGAR LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION ESTIPULADA EN EL ANEXO 12, EN EXCELENTES CONDICIONES EXTERNAS E INTERNAS CON UNA VIDA DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS, USAR REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE LINEA DE ACUERDO A LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, NO ENTREGAR REACTIVOS "SUSTITUTOS"

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA EXTENDER EL TIEMPO MÁXIMO DE VIDA DE USO DE LOS EQUIPOS DE 2 AÑOS, A 5 AÑOS, SIEMPRE Y CUANDO LOS EQUIPOS OFERTADOS ESTÉN EN PERFECTAS CONDICIONES Y CUMPLAN CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD SOLICITADAS EN BASES, YA QUE LA COLOCACIÓN DE EQUIPO NUEVO IMPACTARA DE FORMA MUY IMPORTANTE EL PRECIO DE LOS INSUMOS QUE SERÁN OFERTADOS.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, EXCEPTUANDO LOS EQUIPOS DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA.**

#### PREGUNTA 6

8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO SOLICITAN UNA CANTIDAD CONSIDRABLEMENTE MAYOR DE EQUIPAMIENTO EN COMODATO AL QUE ACTUALMENTE TIENEN, EJEMPLO: 1 EQUIPO DE AFERESIS, 3 CONECTORES ESTARILES, SILLONES, BALANZAS, 3 CENTRIFUGAS, ETC...

TODO ESTE EQUIPAMIENTO REPRESENTA UNA INVERSION ECONOMICA MUY IMPORTANTE PARA LOS LICITANTS, Y CONSIDERANDO QUE EL ACTUAL EVENTO ES SOLO DE 6 MESES, EL IMPACTO DE TODO ESTE EQUIPAMIENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESULTARA EN UN INCREMENTO MUY IMPORTANTE DEL PRECIO ACTUAL.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERAR LA CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL SOLICITADO, AJUSTANDO LA SOLICITUD, A LAS CANTIDADES DE EQUIPO ACTUALMENTE INSTALADO, EN ARAS DE NO INCREMENTAR TANTO EL COSTO DE LOS INSUMOS QUE SE OFERTARAN.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: LAS CANTIDADES DEBERAN SER EN APEGO A LO SOLICITADO EN BADES Y PARA EL TEMA DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS DE MAS DE 2 AÑOS DE USO, PODRA OFERTAR LA MISMA CANTIDAD, DE EQUIPOS EL CUAL SE PERMITE VISITA A LAS INSTALACIONES EL DIA 17 Y 18 DE JUNIO EN UN HORARIO DE 8 A 13 HRS, PREVIO AVISO AL DR. OSCAR ROLANDO AVILA GALVAN, PARA AGENDAR CITA.

**LICITANTE: DISTRIBUIDORA LHAG, S.A. DE C.V.**

**PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:**

1. NUMERAL 15

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR NUESTRA PROPUESTA EN CAJAS DE ARCHIVO Y ENUMERANDO CADA CAJA CONSECUTIVAMENTE DE ACUERDO A LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PORPUESTA.**

2. NUMERAL 15.2

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO APLICA LA FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA (ANEXO 5) ¿ES CORRECTO?.

**RESPUESTA: NO, SE DEBE DE SOLICITAR FIANZA CON UN VALOR DEL 5% DE LA PROPUESTA TOTAL ECONOMICA SIN IVA, EMITIDA POR AFIANZADORA, CHEQUE DE CAJA, O CERTIFICADO. APLICA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.**

3. NUMERAL 17

DEBEMOS ENTENDER QUE NUESTRA PROPUESTA DEBERÁ INTEGRARSE Y ENTREGARSE ORDENADAMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS DE ESTE NUMERAL Y EN CASO DE NO ESTAR ORDENADOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES.**

4. NUMERAL 17, INCISO B)

DEBIDO A QUE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL NO ES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO VIGENTE, DEBEMOS ENTENDER QUE NOS ES NECESARIA LA INSCRIPCION DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA PROPIEDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

5. NUMERAL 17 INCISO C)

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS.**

4.- NUMERAL 17 INCISO R)

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO APLICARÁ ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO ¿ES CORRECTO?

**RESPUESTA: SI ES CORERECTA SU APRECIACIÓN DEBIENDO ENTREGARLO ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.**

5.- NUMERAL 17 INCISO JJ)

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONES EL ANEXO 14 SOLICITADO EN ESTE PUNTO

RESPUESTA: VER ACLARACIONES.

#### PREGUNTAS TÉCNICAS

1. ANEXO 2. DESCRIPCION TECNICA. PAG. 34. EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA SEROLOGIA

\*SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FICHAS TÉCNICAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS PERO QUE SIN EMBARGO SI REALICE EL EQUIPO, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA COMPROMISO.

**RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA Y TODAS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE NO VENGAN EN LAS FICHAS DEBERAN SER ESCRITAS EN CARTA COMPROMISO ( FORMATO LIBRE) Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES.**

2. ANEXO 2. DESCRIPCION TECNICA. PAG. 34. EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA SEROLOGIA.

\*DICE: DIMENSIONES FÍSICAS 185.5 X 1549 X 140 (PROFUNDIDAD, ANCHO, ALTO). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES. 101.5 X120 X 117. DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO INTERFIERE EN EL PROCESO Y RESULTADOS DE ESTE.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SEA AVALADA POR EL COMITE TECNICO..**

3. ANEXO 2. DESCRIPCION TECNICA. PAG. 34 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA SEROLOGIA.

\*SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN ALMACENAMIENTO DE REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE 2500 PRUEBAS, AUNADO A ESTO CON OPCIÓN A ALMACENAMIENTO EXTERNO ILIMITADO A TARJETAS SD.

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.**

4. ANEXO 2. DESCRIPCION TECNICA. PAG. 35 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA HEMATOLOGIA.

\*DICE: ALTURA 14,9" (38 CM)

• ANCHO 12.5 (32 CM)

• PROFUNDIDAD 19,7" (50 CM)

• PESO 41.8 LBS (19 KG) SIN LOS REACTIVOS INCORPORADOS. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES "UNIDAD PRINCIPAL: 420 X 355 X 480 MM. / 33 KG" CONSIDERANDO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS NO INTERFIEREN EN EL PROCESO Y RESULTADOS DE ESTE.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

5. ANEXO 2. DESCRIPCION TECNICA. PAG. 36 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGIA.

\*SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO QUE TRABAJE A TRAVÉS DE RACKS Y BANDEJAS DE CARGA, HACIENDO ASÍ MAS EFICIENTE EL TRABAJO POR MEDIO DE CARGA CONTINUA.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

6. ANEXO 2. DESCRIPCION TECNICA. PAG. 36 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION.

\*SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE COMPUTO ANEXO AL ANALIZADOR QUE CUBRE LA FUNCIÓN DE SOFTWARE AL 100 %

**: RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

7. ANEXO 2.

DESCRIPCION TECNICA. PAG. 36 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA COAGULACION.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page, corresponding to each question and answer block.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO D COAGULACIÓN CON UN RENDIMIENTO DE 60 PRUEBAS POR HORA, CONSIDERANDO QUE LOS BANCOS DE SANGRE NO MANTIENEN UNA CARGA DE TRABAJO EXHAUSTIVA.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

8. ANEXO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. PÁG. 34 EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA SEROLOGÍA

SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTA UN EQUIPOS CON UN ROTOR CON CAPACIDAD PARA 18 REACTIVOS, DEBIDO A QUE LA CAPACIDAD SOLICITADA ES VIABLE PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL HOSPITAL DONDE SE INSTALARÁ DICHO EQUIPO ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

#### INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A DE C.V :

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA:

DICE: TECNOLOGÍA DE ELECTROQUIMIOLUMINISENCIA.

ESTA TECNOLOGÍA ES EXCLUSIVA DEL FABRICANTE ROCHE.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OFERENTES, ACEPTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA.

¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PORPUESTA DE QUIMIOLUMINISCENCIA.**

PUNTO 12.- FORMA DE ADJUDICACIÓN:

DICE: LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR AGRUPAMIENTO DE PARTIDAS.

LA AJUDICACIÓN SERÁ A UN SOLO LICITANTE POR EL TOTAL DE LA PARTIDA Y SUS SUB-PARTIDAS.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEROLOGÍA:

EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE SEROLOGÍA, SE ESTÁ SOLICITANDO QUE EL ANALIZADOR CUENTE CON ROTOR REFRIGERADO ( 4+/-8°C) Y QUE EMITA LOS RESULTADOS DE TODAS LAS DETERMINACIONES EN MENOS DE UNA HORA INDEPENDIEMENTE DEL NÚMERO DE MUESTRAS DE MANERA CONTINUA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, LA MISMA PETICIÓN PARA EL EQUIPO DE RESPALDO.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA??

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.**

EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE SEROLOGÍA, SE ESTÁ SOLICITANDO QUE EL ANALIZADOR CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE REACTIVOS DE 30 DÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.**

EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE SEROLOGÍA, SE ESTÁ SOLICITANDO QUE EL ANALIZADOR CUENTE CON :

CAPACIDAD DE MUESTRAS SIMULTÁNEAS: 80 RUTINA, 20 URGENCIAS  
DETECCIÓN DE COÁGULOS (TECNOLOGÍA DE PRESIÓN DIFERENCIAL) Y BURBUJAS  
ARRASTRE DE MUESTRAS MENOR A 0,1 PPM  
CARGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PERMITE 5 HORAS DE OPERACIÓN DE MANOS  
DIMENSIONES FÍSICAS MÁXIMAS: 1.850 X 160 X 130 (PROFUNDIDAD, ANCHO, ALTO).

ESTAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN AL EQUIPO DE SEROLOGÍA DEL FABRICANTE ROCHE DIAGNOSTICS POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, LA MISMA PETICIÓN PARA EL EQUIPO DE RESPALDO.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA??

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA OPERATIVA. .

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA:

EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA SE SOLICITA TARJETAS DE GEL DE 6 POZOS, ESTA ESPECIFICACIÓN ES ÚNICA DEL FABRICANTE BIORAD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CASETE CON 6 COLUMNAS CON LA TECNOLOGÍA DE PERLAS DE VIDRIO.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA??

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.

A vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink is located on the right side of the page. From top to bottom, it includes a large signature, a circular stamp with a checkmark, a signature, a signature, a signature, a signature, and a large signature at the bottom.